DAWSON-MUELLER CATHÉTER DE DRAINAGE

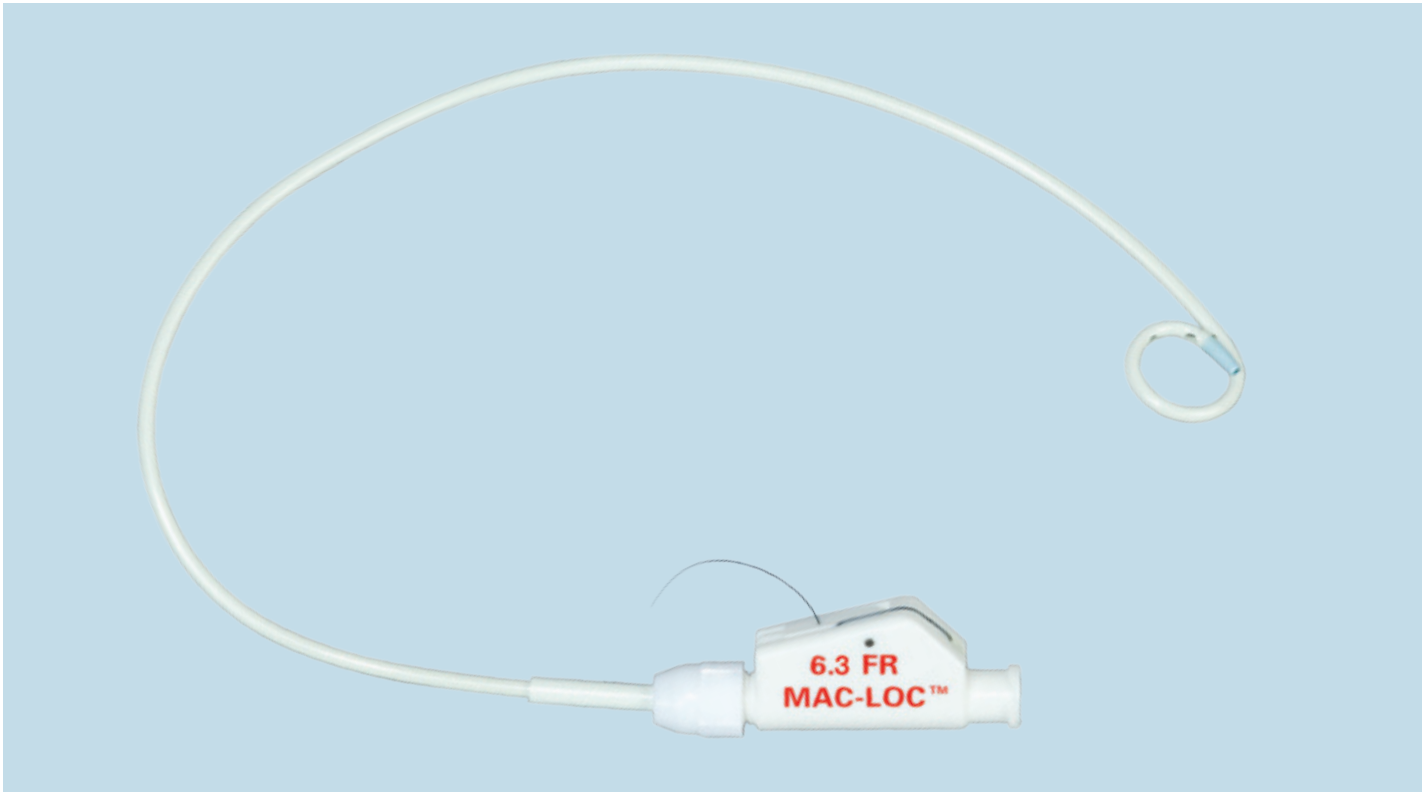

Maintenant compatible avec les guides de 0,035 inch (0,89 mm).

CONVIVIAL
L'extrémité Intro-Tip™ et le revêtement hydrophile AQ® facilitent l'introduction et empêchent au cathéter de se plisser.

SÛR
Le Mac-Loc® à profil bas procure une fixation solide du pigtail 10 mm.

FIABLE
Un cathéter de drainage de pointe fabriqué à partir de matériaux de qualité et conçu pour répondre aux exigences des médecins.

DAWSON-MUELLER
CATHÉTER DE DRAINAGE

INFORMATIONS DE COMMANDE

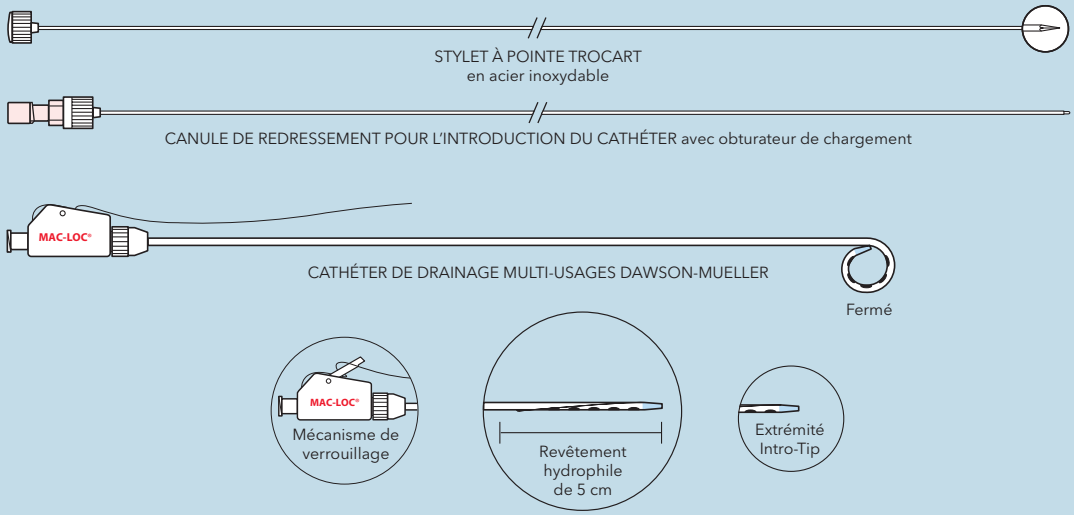

Numéro d'identification produit	Numéro de commande	Cathéter (Fr.)	Diamètre de guide compatible (inch/mm)	Longueur de cathéter (cm)	Orifices latéraux du cathéter	Calibre de l'aiguille du stylet à pointe trocart
G51594	ULT6.3-35-15-P-5S-CLDM-HC	6,3	0,035/0,89	15	5	19 UTW*
G51595	ULT6.3-35-25-P-5S-CLDM-HC	6,3	0,035/0,89	25	5	19 UTW*

* UTW (paroi ultra fine)

Service Clientèle

FRANCE : +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
BELGIUM : +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
SWITZERLAND : +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

NOM DU PRODUIT : Dawson-Mueller Drainage Catheter - Cathéters de drainage Dawson-Mueller, **DESTINATION :** Les cathéters de drainage multi-usages sont conçus pour permettre un drainage percutané lors d'une variété d'applications (néphrostomie, drainage biliaire et d'abcès, par exemple), en recourant à une technique de perforation cutanée directe ou à la technique de Seldinger. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL :** Classe IIb, **ORGANISME NOTIFIE :** LRQA 0088, **FABRICANT :** Cook Incorporated, **MODE D'EMPLOI :** Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical, **REMBOURSEMENT :**Pris en charge par l'assurance maladie. **DATE DE PUBLICATION :** 2013 Janvier

© COOK 2013 IR-BFRM-ULTDS-FR-201301